

スポイト栓(シリコンゴム製)


N-1・N-2

○使用法

- ・ スポイト栓の穴にスポイトを固定して薬液瓶より液体を吸上げます。

○サイズ

(※サイズは測定の仕方によって異なります)

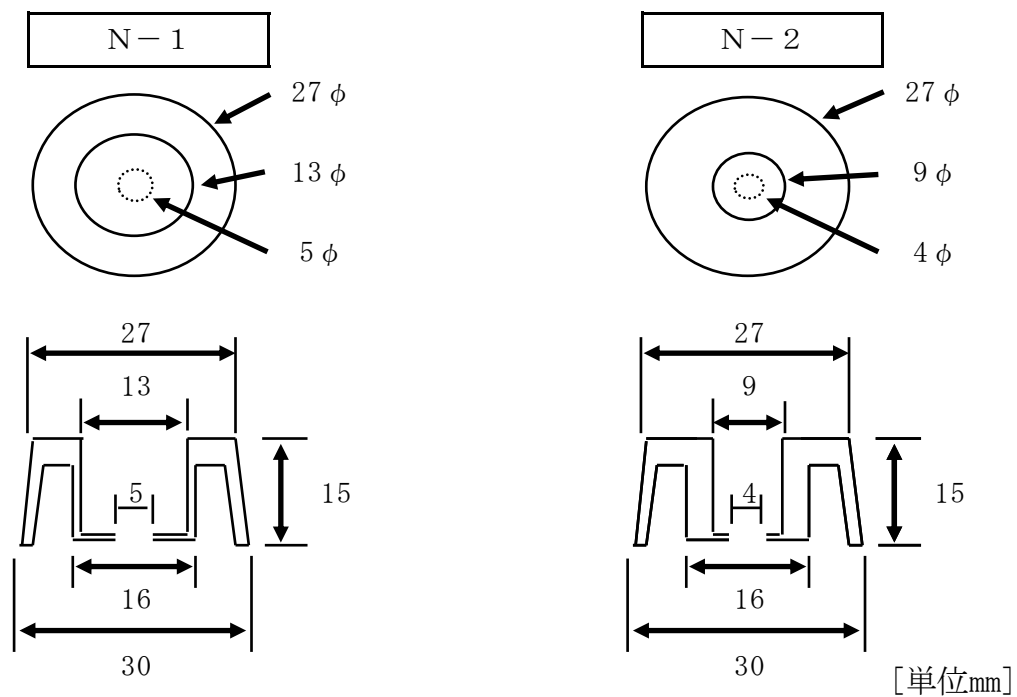

- ・ N-1 … 10cc以上スポイト用
- ・ N-2 … 10cc以下スポイト用
- ・ 試薬瓶500cc用